



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2008/01646

от 29 апреля 2008 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Филипс Медикал Системе Недерланд Б.В.", Нидерланды,
Philips Medical Systems Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621 JG Eindhoven,
The Netherlands

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Монитор пациента IntelliVue MP5 с принадлежностями (см. Приложение на 3 листах)
производства

"Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ", Германия,
Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH, Hewlet-Packard-Str. 2, 71034
Boblingen, Germany.

класс потенциального риска 26

ОКП 94 4180

соответствующее комплекту регистрационной документации


КРД № 14855 от 03.04.2008

приказом Росздравнадзора от 29 апреля 2008 года № 3209-Пр/08

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

В. Юргель

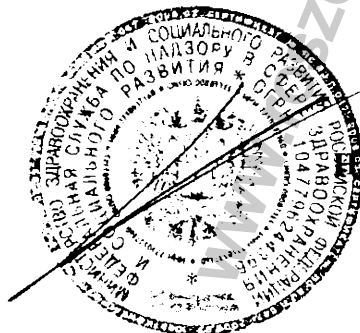

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT

Лист 1


№ ФСЗ 2008/01646

Принадлежности:

1. Разъемы для подключения кабелей.
2. Кабели соединительные:
 - кабели сетевые;
 - кабели коммутационные;
 - трубки коммуникационные;
 - коннекторы;
 - устройства крепления.
3. Магистральные ЭКГ кабели.
4. ЭКГ кабели с 3, 5, 6, 10 электродами с зажимом.
5. ЭКГ кабели с 3, 5, 6, 10 электродами с защелкой.
6. ЭКГ кабели с 3, 5, 6, 10 электродами с клипсой.
7. ЭКГ электроды.
8. Соединительные блоки и разветвители.
9. Манжеты для неинвазивного измерения АД у взрослых, детей и новорожденных.
10. Трубки для манжет для неинвазивного измерения АД у взрослых, детей и новорожденных.
11. Датчики пульсоксиметрические взрослые, детские, неонатальные многоцветные.
12. Датчики пульсоксиметрические взрослые, детские, неонатальные одноцветные.
13. Адаптер к пульсоксиметрическому датчику.
14. Кабель адаптера к пульсоксиметрическому датчику.
15. Кабель удлинительный пульсоксиметрического датчика.
16. Датчик температуры универсальный многоцветный.
17. Датчик температуры универсальный одноцветный.
18. Датчик температуры наружный многоцветный.
19. Датчик температуры наружный одноцветный.
20. Датчик температуры катетера Фолея.
21. Зонд температурный неонатальный.
22. Зонд температурный пищеводный.
23. Адаптер датчика температуры.
24. Кабель адаптера датчика температуры.
25. Держатель для датчика прогноза температуры.
26. Крышки для датчика температуры, одноцветные.
27. Датчики для инвазивного измерения давления.
28. Адаптеры датчика инвазивного измерения давления.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития**

29 апреля 2008 года

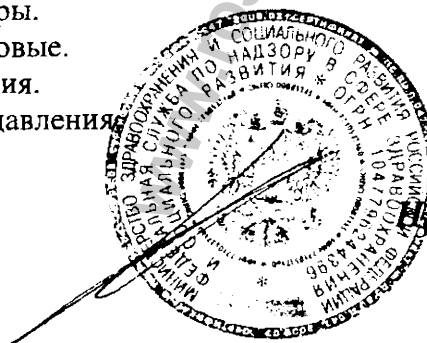

В. Юргель

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**


Лист 2

№ ФСЗ 2008/01646

29. Колпачки для инвазивного измерения давления, одноразовые.
30. Держатели датчика инвазивного давления.
31. Одноканальные сенсоры к датчику инвазивного давления.
32. Двухканальные сенсоры к датчику инвазивного давления.
33. Магистралы для датчиков инвазивного измерения давления.
34. Адаптер для сенсоров.
35. Крепеж к инфузионной стойке.
36. Кабель адаптера для сенсоров.
37. Датчик для капнографии.
38. Адаптер воздуховода.
39. Назальные и орально-назальные канюли для взрослых, детей и грудных детей.
40. Пробозаборные трубки.
41. Модуль измерения анестезиологических газов.
42. Блок радиометра калибровочный ТССЗ.
43. Фиксирующие устройства для модуля измерения газов.
44. Стартовый комплект для установки мембран:
 - фиксационные кольца;
 - съемник уплотнительных колец;
 - промокательная бумага;
 - раствор электролита;
 - контактная жидкость;
 - мембрана;
 - газ калибровочный во флаконах.
45. Трубки.
46. Линии возврата отработанных газов.
47. Фильтры возврата отработанных газов.
48. Влагодеталь.
49. Трубки забора проб газа.
50. Кабель для подсоединения устройства беспроводного мониторинга.
51. Устройство беспроводного мониторинга.
52. Устройство для дистанционного отображения информации.
53. Кабели аналоговые.
54. Стойка настольная.
55. Подвижная стойка.
56. Регистратор.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития**

29 апреля 2008 года

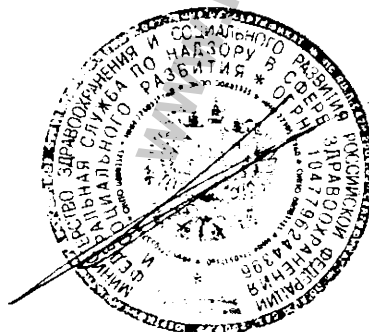


Н.В. Юргель

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 3


№ ФСЗ 2008/01646

57. Бумага для регистратора.
58. Устройство сетевой передачи данных PHILIPS Medical LAN.
59. Кабель адаптера LAN.
60. Блок питания.
61. Интерфейс MIB.
62. Программное обеспечение для монитора.
63. Адаптер.
64. Батарея аккумуляторная.
65. Инструкция по эксплуатации для монитора.
66. Сервисная инструкция для монитора.
67. Обучающая и сервисная информация на CD.

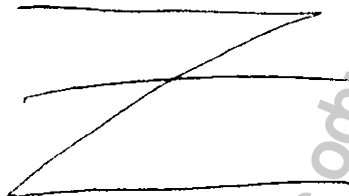

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

29 апреля 2008 года

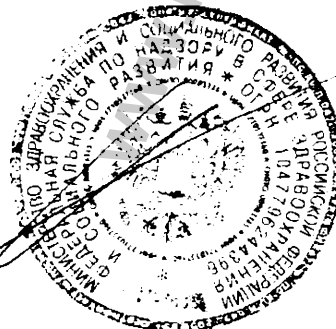

Н.В. Юргель